

指定医薬品 処方せん医薬品^{注)}

経皮吸収 気管支拡張剤 ^{注)} 注意-医師等の処方せんにより使用すること [薬価基準収載]

ツロブテロールテープ 0.5mg「HMT」 1mg「HMT」 2mg「HMT」

『薬剤のフィルム改良(密着フィルム)』に伴う 『商品中箱・外箱の記載内容変更』のご案内

謹啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当社商品に格別のご高配を頂き、厚く御礼申し上げます。さて、この度経皮吸収気管支拡張剤ツロブテロールテープ(0.5mg・1mg・2mg)「HMT」の薬剤のフィルム改良(密着フィルム)に伴い商品中箱・外箱の記載内容を一部変更いたしますのでご案内申し上げます。今後ともなお一層のご愛顧をいただきますようお願いいたします。

謹白

久光製薬株式会社

改良点・変更点

改良点① 薬袋から薬剤を取り出す際に、フィルムだけが取れてしまうことがないように「密着フィルム」を採用しました。

変更点① 『薬剤のフィルム改良(密着フィルム)』に伴い、中箱・外箱に「フィルム改良品」と表示しました。

変更点② 商品同梱の『患者様指導箋』の記載内容をわかりやすくしました。

下記の製造番号の商品から変更いたします。

品名	包装	サイズ・重量	変更開始ロット	出荷時期(予定)
ツロブテロールテープ0.5mg	70枚包装	変更なし	HC01T	1月下旬
	350枚包装			2月中旬
ツロブテロールテープ1mg	70枚包装		HB03T	1月中旬
	350枚包装			
ツロブテロールテープ2mg	70枚包装		HC01T	2月上旬
	350枚包装			

変更の際しまして、流通段階の在庫の関係で現行商品と変更商品が混在する場合がございます。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。


改良点

フィルム




薬袋から薬剤を取り出す際に、フィルムだけが取れてしまうことがないように「密着フィルム」を採用しました。

現行品フィルム

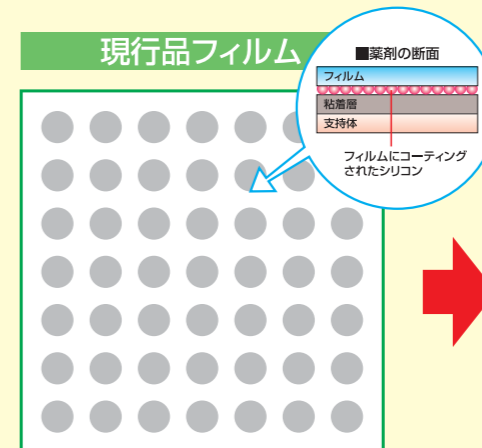

粘着層との接地面が狭い。

改良品フィルム

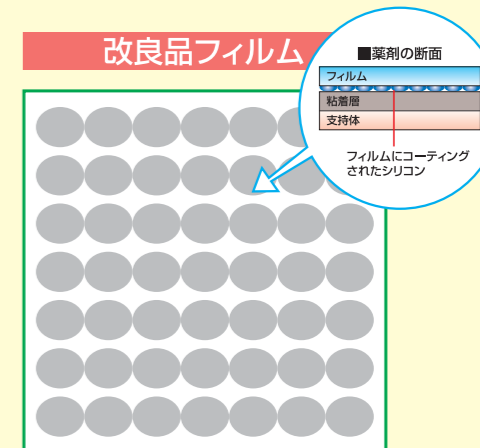

粘着層との接地面が広い。

※この図は、フィルムにコーティングされたシリコンの接地面積の比較をイメージしたものです。

変更点


患者様指導箋

現行品



記載内容をわかりやすくしました。


変更品

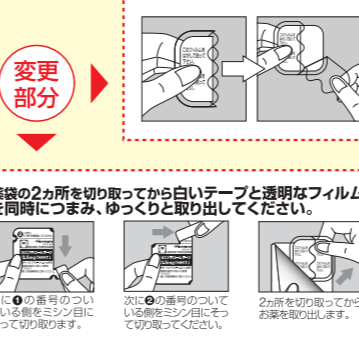

※指導箋は70枚包装につき10枚、350枚包装につき50枚同梱しています。

中箱

現行品

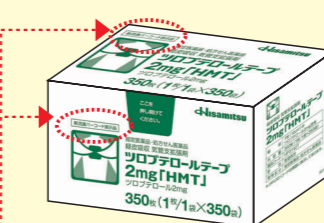

新流通バーコード表示品



変更品




外箱

現行品



新流通バーコード表示品



変更品



※イラストは2mg(350枚・70枚包装)ですが、その他のアイテムも同様の変更となります。