

関節機能改善剤

ヒルネート® 関節注シリンジ25mg


シリンジ形状・シリンジラベル・ブリスターパックフタ・
ブリスターパック形状・中箱・包装ダンボールの表示内容変更のご案内

謹啓
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は当社商品に格別のご高配を頂き、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、関節機能改善剤「ヒルネート関節注シリンジ 25mg」のシリンジ形状・シリンジラベル・ブリスターパックフタ・ブリスターパック形状・中箱・包装ダンボールの表示の一部を変更致しますので下記の通りご案内を申し上げます。
今後ともなお一層のご愛顧を頂きますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

久光製薬株式会社

シリンジ形状

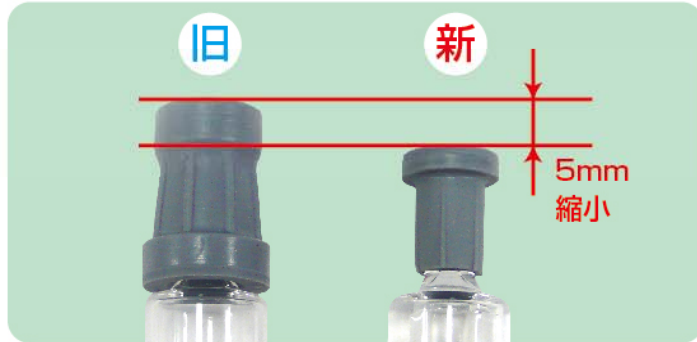

※キャップ形状を変更します。





※フィンガーフランジの幅が広がります。

シリンジラベル



※印字部分が変更となります。

ブリスターパックフタ

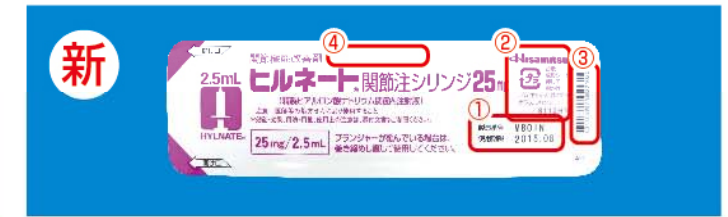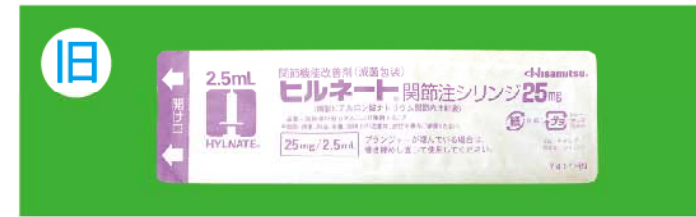


- ①製造番号と使用期限をフタにも表示します。
- ②フタ材質を紙からプラスチックに変更します。
- ③従来はブリスターパックヘシール貼りしていたGS1コードをブリスターフタへ直接印刷します。
- ④「滅菌包装」の表示を削除します。

ブリスターパック形状



※注射のフィンガーフランジとキャップ形状変更により、ブリスターパック形状を変更します。

中箱

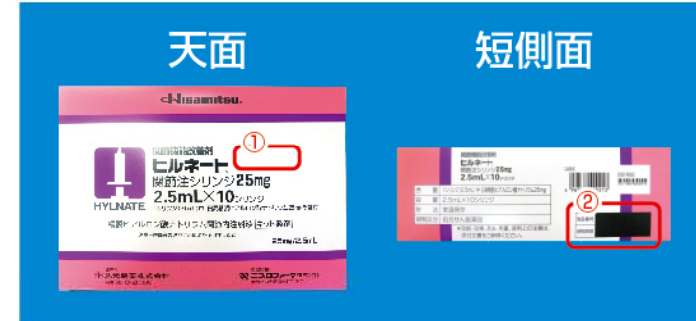

- ①「滅菌包装」の表示を削除します。
 - ②製造番号と使用期限印字位置を変更します。
- ※ブリスターパック形状変更により中箱寸法が変更になります。

	縦長さ(mm)	横長さ(mm)	高さ(mm)
現行品	175	205	60
変更品	175	239	60

包装ダンボール

※中箱寸法変更により外箱寸法も変更になります。

	縦長さ(mm)	横長さ(mm)	高さ(mm)
現行品	216	367	135
変更品	248	365	135

※封じテープを透明から茶色へ変更します。
※「滅菌包装」の表示を削除します。

変更品製造番号と出荷予定時期

包装	変更品製造番号	当社出荷予定時期
ヒルネート関節注シリンジ25mg 2.5mL×10シリンジ	M801N	2012年12月中旬

出荷時期は、在庫の状況により前後することがございます。変更の際に際しまして、流通段階の在庫の関係で現行商品と変更商品が混在する場合がございます。大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。